Vibrosonic alpha

# Gebrauchsanweisung für den Nutzer

vibrosonic

# Inhaltsverzeichnis

1 Vibrosonic alpha ..... 2
2 Beschreibung Vibrosonic alpha ..... 3
2.1 Zweckbestimmung ..... 3
2.2 Vibrosonic alpha im Detail ..... 3
2.2.1 Gehörgangsmodul und Hörkontaktlinse® ..... 4
2.2.2 Klangprozessor mit Magnetkabel ..... 5
2.2.3 Transportetui für den Klangprozessor ..... 5
2.2.4 Patienteninformationskarte ..... 6
3 Mögliche Nebenwirkungen und Restrisiken ..... 6
4 Handhabung der Vibrosonic alpha ..... 6
4.1 Batterie einlegen und wechseln ..... 6
4.2 Ein- und Ausschalten des Hörsystems ..... 8
4.3 Anlegen des Klangprozessors ..... 9
4.4 Durchführen eines Funktionstests ..... 10
4.5 Programmwechsel/-einstellung ..... 11
5 Transport und Lagerung ..... 11
6 Pflege und Wartung ..... 12
7 Kontrolltermin ..... 12
8 Service ..... 12
9 Nachbestellung von Komponenten ..... 13
10 Konformitätserklärung ..... 14
11 Hinweise und Symbolerklärung ..... 15
12 Wichtige Sicherheitsinformationen ..... 17
12.1 Warnhinweise ..... 17
12.2 Hinweise zur Produktsicherheit ..... 19
A1 Außerbetriebnahme und Entsorgung ..... 20
A2 Notizen ..... 21
A3 Produktschilder ..... 22

# 1 Vibrosonic alpha

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Vibrosonic GmbH entschieden haben. Der Lautsprecher ihres neuen Hörsystems, die Hörkontaktlinse®, wird bei Vibrosonic alpha direkt auf dem Trommelfell getragen. Beim natürlichen Hören trifft der Schall am Ende des Gehörgangs auf das Trommelfell und versetzt es in Schwingung. Die von der Vibrosonic GmbH entwickelte Hörkontaktlinse® funktioniert nach dem gleichen Prinzip: anstelle von Lautsprechern im Ohr, die den Schall wiedergeben, erfolgt die Klangübertragung durch direkte mechanische Stimulation des Gehörs. Das Ergebnis ist ein möglichst natürliches Hörerlebnis.

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für das Hörsystem Vibrosonic alpha. **Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgsam durch.** Einzelne Komponenten von Vibrosonic alpha werden direkt auf dem Trommelfell oder im Gehörgang getragen. Dadurch gilt es wichtige Hinweise zu beachten, damit Sie Ihr Hörsystem optimal nutzen können. Vibrosonic alpha ist für Patienten ab 18 Jahren mit einer rein sensorineuralen, leichten bis mittleren Schwerhörigkeit geeignet.

Ihr Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO-Arzt) wird regelmäßige Kontrolltermine mit Ihnen vereinbaren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Hörsystem optimal funktioniert.

Ihr Hörakustiker führt die audiologische Anpassung Ihrer Vibrosonic alpha durch. Diese ist vor der ersten Inbetriebnahme notwendig und erfolgt ansonsten nur nach Bedarf. Dieser Gebrauchsanweisung ist das Technische Datenblatt von Vibrosonic alpha beigelegt. Dem Technischen Datenblatt sind weiterführende Informationen für den Hörakustiker zu entnehmen.

**Herstellerangaben:**


| | |
|---|---|
| Vibrosonic GmbH | Tel.: +49 621 180 62 69-0 |
| Franz-Volhard-Straße 3 | Fax: +49 621 180 62 69-9 |
| 68167 Mannheim | Mail: info@vibrosonic.de |
| **Germany** | Web: www.vibrosonic.de |

# 2 Beschreibung Vibrosonic alpha

## 2.1 Zweckbestimmung

Vibrosonic alpha wird verwendet, um eine Schwerhörigkeit mittels Aufnahme, elektronischer Verarbeitung und Abgabe einer mechanischen Vibration auf das Trommelfell zu kompensieren. Das Produkt wird an der Ohrmuschel und im Gehörgang bis zum Trommelfell auf unverletzter Haut getragen. Die Anwendungsdauer ist unbegrenzt. Es ist kein chirurgischer Eingriff nötig.

## 2.2 Vibrosonic alpha im Detail

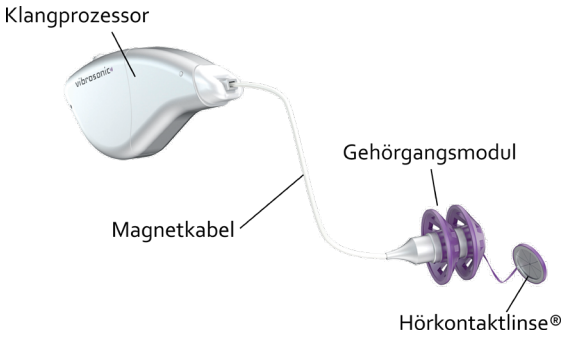


Vibrosonic alpha besteht aus drei wesentlichen Komponenten:

- der Hörkontaktlinse®, einem Mikrolautsprecher, der auf dem Trommelfell getragen wird,
- dem Gehörgangsmodul, dieses ist fest mit der Hörkontaktlinse® verbunden und wird dauerhaft im Gehörgang getragen, sowie
- dem Klangprozessor, welcher Elektronik, Batterie und Mikrofone beinhaltet.

Klangprozessor und Gehörgangsmodul sind über das Magnetkabel miteinander verbunden. Diese Verbindung können Sie selbst herstellen und wieder lösen, um den Klangprozessor bei Bedarf abzulegen. Hörkontaktlinse® und

Gehörgangsmodul sind für den dauerhaften Verbleib im Gehörgang vorgesehen und durch das Verbindungskabel fest miteinander verbunden.

In den folgenden Abschnitten sind einzelne Komponenten von Vibrosonic alpha im Detail erklärt.

### 2.2.1 Gehörgangsmodul und Hörkontaktlinse®

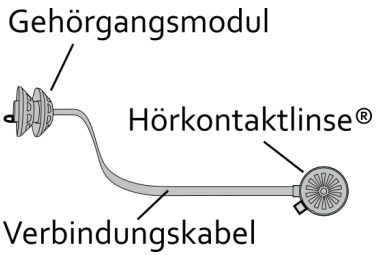


Die Hörkontaktlinse® wird direkt auf das Trommelfell aufgelegt. Sie ist mit dem Gehörgangsmodul durch das Verbindungskabel fest verbunden. Das Gehörgangsmodul wird durch weiche Ohrpassstücke im Gehörgang gehalten. An seinem äußeren Ende besitzt es eine magnetische Schnittstelle zum Magnetkabel des Klangprozessors. Die Hörkontaktlinse® sowie das Gehörgangsmodul sind zum dauerhaften Verbleib im Gehörgang vorgesehen.

### 2.2.2 Klangprozessor mit Magnetkabel

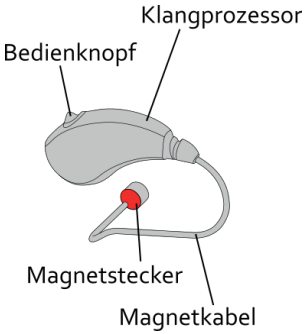


Der Klangprozessor ist individuell auf Ihr Ohr angepasst und wird Ihnen von Ihrem Arzt ausgehändigt. Der Klangprozessor wird hinter dem Ohr getragen, während das Magnetkabel zur Verbindung mit dem Gehörgangsmodul in den Gehörgang führt. Die Farbmarkierung am Magnetstecker gibt an, ob es sich um einen Klangprozessor für das linke (**BLAU**) oder rechte (**ROT**) Ohr handelt.
Der Klangprozessor verfügt über einen Bedienknopf, mit dem Sie einen Funktionstest oder Programmwechsel durchführen können (s. Kapitel 4.4 und 4.5).

### 2.2.3 Transportetui für den Klangprozessor



Das Transportetui dient zum sicheren Transport und zur Lagerung des Klangprozessors bei Nichtgebrauch. Bitte bei Bedarf stets verwenden.

### 2.2.4 Patienteninformationskarte



Die Patienteninformationskarte wird Ihnen von Ihrem HNO-Arzt ausgehändigt. Diese stellt wichtige Informationen für Sie und Ihren HNO-Arzt bereit. Bitte tragen Sie die Patienteninformationskarte stets bei sich, um sie bei Bedarf einem Arzt zeigen zu können.

# 3 Mögliche Nebenwirkungen und Restrisiken

Beim Gebrauch der Vibrosonic alpha können folgende Nebenwirkungen auftreten:

- Druckgefühl bis hin zu Schmerzen im Gehörgang
- Irritationen und Entzündungen im Gehörgang (Juckreiz, Schmerzen, Schwellung, in seltenen Fällen auch Infektion mit Krankheitserregern)
- Verletzungen von Trommelfell und/oder Gehörgang
- Verschlussgefühl des Gehörgangs mit veränderter Wahrnehmung der eigenen Stimme
- Reizreaktion wie Husten, Schwindel, Desorientierung während des Einsetzens
- In sehr seltenen Fällen: Gehörschäden

# 4 Handhabung der Vibrosonic alpha

## 4.1 Batterie einlegen und wechseln

**Vibrosonic alpha benötigt eine Hörgerätebatterie des Typs 312 bzw. PR41** (braune Farbmarkierung auf der Verpackung). Die folgenden Schritte beschreiben das Einsetzen oder Wechseln der Batterie des Klangprozessors.

Öffnen Sie vorsichtig das Batteriefach am Klangprozessor.

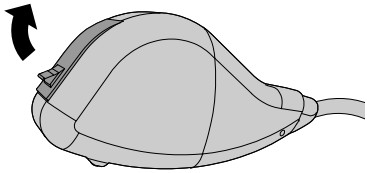

Falls vorhanden, entnehmen Sie die alte Batterie und entsorgen Sie diese fachgerecht.

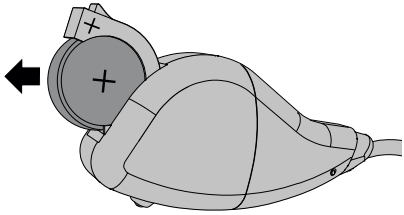

Nehmen Sie die neue Batterie aus ihrer Verpackung und entfernen Sie den farbigen Schutzstreifen. Warten Sie 2 – 3 Minuten bevor Sie die Batterie einlegen.

Legen Sie die neue, geladene Batterie so ins Batteriefach ein, dass die Plusmarkierung auf der Batterie mit der Plusmarkierung auf dem Batteriefach übereinstimmt.

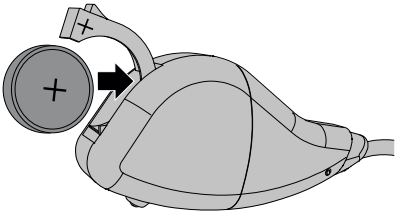

Schließen Sie das Batteriefach vorsichtig. Nur wenn die Batterie richtig herum im Batteriefach eingelegt ist, lässt sich dieses leicht schließen.

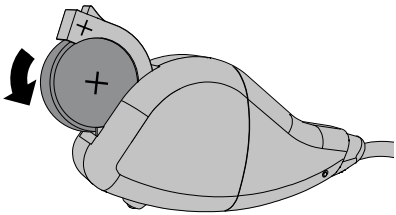

Drei Töne in abnehmender Tonhöhe signalisieren, dass die Batteriespannung geringer wird und Sie eine neue Batterie in den Klangprozessor einlegen müssen. Ab diesem Zeitpunkt verbleiben noch ca. 10 – 60 Minuten, bis sich der Klangprozessor abschaltet.

## 4.2 Ein- und Ausschalten des Hörsystems

Zum Einschalten der Vibrosonic alpha eine geladene Batterie gemäß der Markierung im Klangprozessor einlegen und das Batteriefach schließen.

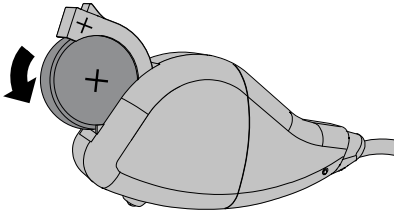

Zum Ausschalten der Vibrosonic alpha das Batteriefach am Klangprozessor öffnen.

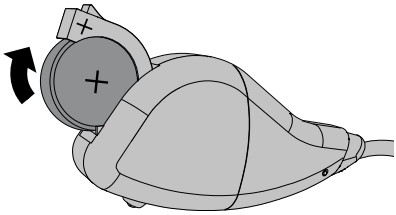

## 4.3 Anlegen des Klangprozessors

Entnehmen Sie Ihren Klangprozessor dem Transportetui. Achten Sie für die Auswahl der richtigen Ohrseite auf die Farbmarkierung am Magnetstecker des Klangprozessors.

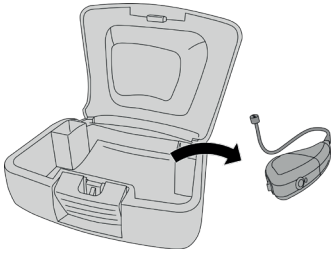

Legen Sie den Klangprozessor hinter dem Ohr an. Das Magnetkabel mit dem Magnetstecker befindet sich jetzt nah am Eingang des Gehörgangs.



Schieben Sie mit dem Finger das Kabel in den Gehörgang, bis Sie ein Klicken hören. Dann ist der Magnetstecker mit dem Gehörgangsmodul verbunden.



Um den Klangprozessor zu entfernen, trennen Sie die Magnetverbindung durch Ziehen am Magnetkabel und nehmen Sie den Klangprozessor vom Ohr ab. Verstauen Sie den Klangprozessor anschließend im Transportetui, um ihn bei Nichtgebrauch sicher zu transportieren und zu lagern.

## 4.4 Durchführen eines Funktionstests

Führen Sie einen Funktionstest durch, um festzustellen, ob Vibrosonic alpha ordnungsgemäß funktioniert.

Verbinden Sie Klangprozessor und Gehörgangsmodul mit Hilfe des Magnetkabels.

Den Bedienknopf am Klangprozessor länger als 2 Sekunden drücken, um die Wiedergabe des Testtons auszulösen. Der Testton besteht aus einer Tonfolge von mindestens drei Tönen mit aufsteigender Tonhöhe.



Wenn Sie den Testton hören können, war der Funktionstests erfolgreich. Falls Sie den Testton nicht oder nur unvollständig wahrnehmen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Trennen und verbinden Sie den Magnetstecker mehrfach. Führen Sie erneut einen Funktionstest durch.
- Legen Sie eine frische Batterie in den Klangprozessor ein und führen Sie erneut einen Funktionstest durch.
- Wenn die Funktion von Vibrosonic alpha nicht wiederhergestellt werden konnte, suchen Sie einen zertifizierten HNO-Arzt auf.

## 4.5 Programmwechsel/-einstellung

Der Klangprozessor besitzt einen Bedienknopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Wenn Sie Vibrosonic alpha einschalten, wird automatisch Programm 1 gewählt. Für einen Wechsel zum nächsten Programm, drücken Sie einmal kurz den Bedienknopf am Klangprozessor.

Das gewählte Programm wird durch folgende Töne signalisiert:

| Programm-Nr. | Signalton | Programm verfügbar | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Programm 1 | 1x kurz | ☐ | |
| Programm 2 | 2x kurz | ☐ | |
| Programm 3 | 3x kurz | ☐ | |
| Programm 4 | 4x kurz | ☐ | |
| Programm 5 | 1x lang | ☐ | |
| Programm 6 | 1x lang + 1x kurz | ☐ | |
| Programm 7 | 1x lang + 2x kurz | ☐ | |
| Programm 8 | 1x lang + 3x kurz | ☐ | |

# 5 Transport und Lagerung




Vibrosonic alpha ist nur in Temperaturumgebungen von -10°C bis 65°C funktionstüchtig und sollte dementsprechend auch nur innerhalb dieses Temperaturbereichs gelagert werden.

# 6 Pflege und Wartung

Halten Sie die Kontakte des Magnetsteckers trocken. Ansonsten kann die Hörqualität beeinträchtigt werden.

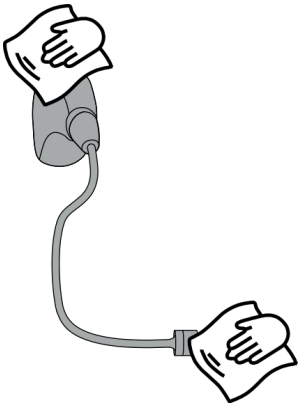

**Wöchentlich:** Reinigen Sie Klangprozessor und Magnetstecker mit einem angefeuchteten Tuch oder mit einem speziellen Reinigungstuch für Hörgeräte. Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem flusenfreien Tuch.

**Täglich:** Überprüfen Sie den Magnetstecker am Magnetkabel auf Cerumen- und Feuchtigkeitsreste. Reinigen Sie diesen gegebenenfalls mit einem angefeuchteten Tuch oder einem speziellen Reinigungstuch für Hörgeräte. Trocknen Sie die Oberflächen anschließend mit einem flusenfreien Tuch.

Zur Reinigung der sich dauerhaft im Gehörgang befindlichen Komponenten wenden Sie sich an Ihren HNO-Arzt.

# 7 Kontrolltermin

Um einen optimalen Betrieb der Vibrosonic alpha sicherzustellen, werden von Ihrem HNO-Arzt regelmäßige Kontrollen durchgeführt. Diese Kontrolltermine wird Ihr HNO-Arzt mit Ihnen vereinbaren.

# 8 Service

Als Hersteller steht Ihnen die Vibrosonic GmbH bei Fragen, z. B. zur Handhabung und zur Pflege, gerne zur Seite. Sollte die Funktionstüchtigkeit von

Vibrosonic alpha beeinträchtigt sein, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Vibrosonic GmbH.

Telefon: +49 621 180 625-55
E-Mail: service@vibrosonic.de

Konsultieren Sie Ihren von Vibrosonic zertifizierten HNO-Arzt, wenn

- Sie Schmerzen oder ein unangenehmes Druckgefühl im Ohr spüren.
- Gehörgangsmodul oder Hörkontaktlinse® neu platziert werden müssen.
- Vibrosonic alpha trotz frischer Batterie keinen Ton mehr ausgibt.
- eine MRT-Untersuchung bei Ihnen geplant ist.
- sonstige Nebenwirkungen auftreten.
- die Funktion von Vibrosonic alpha durch Verschmutzungen am Gehörgangsmodul beeinträchtigt wird.

Konsultieren Sie Ihren Hörakustiker, wenn

- Vibrosonic alpha unangenehmen Schall abgibt.
- die Leistung von Vibrosonic alpha nachlässt.
- Sie mit den audiologischen Einstellungen Ihres Hörsystems nicht zufrieden sind.
- Sie wasserdichte Ohrstöpsel benötigen.

# 9 Nachbestellung von Komponenten

Bei Beschädigung oder Verlust können einzelne Komponenten von Vibrosonic alpha unter Angabe der unten aufgeführten Artikelnummern von der Vibrosonic GmbH bezogen werden. Eine Ausnahme bildet die Batterie, welche handelsüblich ist und nicht von der Vibrosonic GmbH bezogen werden kann. Die im Gehörgang verbleibenden Komponenten können von Ihrem zertifizierten HNO-Arzt ausgetauscht werden.

| **Beschreibung** | **Artikel-Nr.** |
|---|---|
| Magnetkabel | FVBG001 |
| Klangprozessor | FBEM001 |
| Patienteninformationskarte | FPIK001 |
| Gebrauchsanweisung für den Nutzer | FGAP001 |
| Transportetui | FAXB001 |

# 10 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Vibrosonic GmbH, dass das Produkt Vibrosonic alpha in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 93/42/EWG für Medizinprodukte entwickelt wurde.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist direkt beim Hersteller erhältlich.

# 11 Hinweise und Symbolerklärung

**Warnungen:**
Text, der mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, muss vor Gebrauch des Gerätes gelesen werden.

---

**Hinweis:**
Text, der mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, enthält wichtige Informationen zur Handhabung mit dem Hörsystem und dessen Produktsicherheit.

---

**Gebrauchsanweisung beachten:**
Weist darauf hin, dass die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung unbedingt gelesen werden muss.

---

**Hersteller:**
Das Medizinprodukt wird vom Hersteller gemäß der EU-Richtlinie 93/42/EWG produziert. Dessen Name und Adresse ist neben dem Symbol angegeben. Ggf. wird unter diesem Symbol ein Datum angegeben, welches dem Herstelldatum des entsprechenden Produktes entspricht.

---

**CE-Kennzeichen:**
Das Produkt entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Die vierstellige Nummer gibt die Kennnummer der benannten Stelle an.



**Nicht im Hausmüll entsorgen:**
Weist darauf hin, dass das gekennzeichnete Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern getrennt gesammelt werden muss.

---




**Temperaturgrenzen:**
Zeigt an, innerhalb welcher Temperaturgrenzen das Produkt gelagert, transportiert und verwendet werden soll (hier zwischen -10°C und 65°C).

---

**Medizinprodukt:**
Kennzeichnet ein Medizinprodukt.

---

**Katalognummer:**
Gibt die Katalognummer des Herstellers an, so dass ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.

---

**Seriennummer:**
Gibt die Seriennummer des Herstellers an, so dass ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.

# 12 Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie sich die folgenden Warn- und Sicherheitshinweise vor Gebrauch der Vibrosonic alpha sorgfältig durch.

## 12.1 Warnhinweise

| | |
|---|---|
| | Vor einer Magnetresonanztomographie (MRT-Untersuchung, „Kernspin") muss Ihre Vibrosonic alpha von einem HNO-Arzt vollständig entnommen werden. Bei Nichtentfernen können Verbrennungen oder Verletzungen des Trommelfells, des Mittelohrs oder des Innenohrs auftreten. |
| | Vibrosonic alpha muss von einem Hörakustiker eingestellt werden, um die Hörminderung optimal zu kompensieren. Es darf nur vom vorgesehenen Träger getragen werden, da es individuell auf diesen angepasst wird. Geschieht das nicht, kann dies bei längerfristiger Anwendung zu einem Gehörschaden führen. |
| | Verwenden Sie ausschließlich Hörgerätebatterien des vorgesehenen Typs 312 (PR41). Eine Verwendung eines anderen Batterietyps kann Vibrosonic alpha beschädigen, zu Verbrennungen durch Hitzeentwicklung oder zu Reizungen durch auslaufende Flüssigkeiten führen. |
| | Suchen Sie zur Reinigung Ihres mit Vibrosonic alpha versorgten Ohres einen zertifizierten HNO-Arzt auf. Wenn Sie selbst oder eine unkundige Person das betroffene Ohr reinigen, kann es durch Verschieben der Komponenten im Gehörgang zu Verletzungen des Trommelfells kommen. |
| | Suchen Sie einen zertifizierten HNO-Arzt auf, wenn sich Ihre Hörkontaktlinse® oder Ihr Gehörgangsmodul merkbar verschoben oder aus dem Gehörgang gelöst haben. Versuchen Sie nicht, Komponenten der Vibrosonic alpha selbst neu zu positionieren oder von einem Laien positionieren zu lassen! Dies kann zu Verletzungen des Trommelfells, des Mittelohrs und/oder des Innenohrs bis hin zur Ertaubung führen. |

| | |
|---|---|
| | Folgende Vorgänge können Vibrosonic alpha beschädigen und/oder die Funktionalität stören:<br>- Herunterfallen<br>- Eintauchen in Flüssigkeit (Schwimmen, Tauchen)<br>- Starke, elektromagnetische Felder (z.B. Metalldetektoren, Körperscanner, medizinische Geräte u.A. für bildgebende Verfahren, Sendeanlagen)<br>- Übermäßige Wärme (z.B. Sauna und starke Sonneneinstrahlung)<br>Dies kann zu Beeinträchtigung oder Verlust der Funktion von Vibrosonic alpha führen. Wenden Sie sich ggf. an einen zertifizierten HNO-Arzt.<br>Beachten Sie auch die Hinweise im nächsten Abschnitt. |
| | Bewahren Sie Vibrosonic alpha und seine abnehmbaren Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Verschlucken von Kleinteilen kann zum Tod durch Ersticken führen. |
| | Hörkontaktlinse® und Gehörgangsmodul dürfen nur durch einen zertifizierten HNO-Arzt eingesetzt werden. Da Teile der Vibrosonic alpha im Gehörgang und auf dem Trommelfell positioniert werden, kann das Einsetzen oder die Wartung durch einen Laien zu Verletzungen am Trommelfell, Mittelohr und/oder Innenohr führen. |
| | Verwenden Sie Vibrosonic alpha nicht in gekennzeichneten Bereichen mit explosiven oder sauerstoffangereicherten Atmosphären („Ex-Zonen"). Nichtbeachtung kann zu Explosionen und Bränden mit schweren Personen- und Sachschäden führen. Entfernen Sie Ihren Klangprozessor vor Betreten solcher Zonen. |
| | Verbinden Sie Vibrosonic alpha nur mit den vom Hersteller vorgesehenen Komponenten. Das Anschließen von anderen elektrischen Geräten ist nicht zulässig. Werden andere elektrische Geräte angeschlossen, kann dies zu Beschädigungen an Vibrosonic alpha oder zu einem elektrischen Schlag führen. |

## 12.2 Hinweise zur Produktsicherheit

| | |
|---|---|
| | Nehmen Sie die Batterie aus dem Klangprozessor, wenn Sie Vibrosonic alpha längere Zeit (mehr als einen Tag) nicht verwenden und lagern Sie den Klangprozessor stets im vorgesehenen Transportetui. |
| | Nehmen Sie den Klangprozessor ab und kontaktieren Sie den Service der Vibrosonic GmbH, falls Teile der Vibrosonic alpha unangenehm warm werden. |
| | Nehmen Sie den Klangprozessor ab und kontaktieren Sie Ihren Hörakustiker, falls Vibrosonic alpha unangenehmen Schall abgibt. |
| | Damit die Funktion Ihrer Vibrosonic alpha erhalten bleibt, suchen Sie bitte regelmäßig einen zertifizierten HNO-Arzt auf. Dieser informiert Sie über die empfohlenen Zeitabstände und vereinbart die Kontrolltermine mit Ihnen. |
| | Vibrosonic alpha ist nicht wasserdicht. Um eine Schädigung zu vermeiden, entfernen Sie Ihren Klangprozessor vor Aktivitäten, bei denen es zu Kontakt mit Flüssigkeiten oder starker Hitzeeinwirkung kommen kann, wie z.B. intensivem Sport, Saunabesuchen, Schwimmen und Duschen.<br>Wenden Sie sich ggf. an einen zertifizierten HNO-Arzt.<br>Beachten Sie auch den nächsten Hinweis zu Schwimmen und Duschen. |
| | Zum Schwimmen oder anderen Aktivitäten, bei denen der Kopf unter Wasser geraten kann, muss der Gehörgang mit einem Schwimmstöpsel verschlossen werden. Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach wasserdichten Ohrstöpseln.<br>Richten Sie beim Duschen außerdem den Wasserstrahl nie direkt auf den Gehörgang. Vibrosonic alpha könnte Schaden nehmen, verrutschen oder sich aus ihrem Gehörgang lösen.<br>Wenden Sie sich ggf. an einen zertifizierten HNO-Arzt. |

| | |
|---|---|
| | Führen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an Vibrosonic alpha durch. Dadurch können Schädigungen am Hörsystem hervorgerufen werden. Die Vibrosonic GmbH kann für Schädigungen, die aufgrund nicht-autorisierter Änderungen oder Modifikationen resultieren, nicht haftbar gemacht werden. |
| | Wenden Sie sich an Ihren HNO-Arzt, wenn der Kontakt zwischen Ihrem Klangprozessor und dem Gehörgangsmodul unzuverlässig ist („Wackelkontakt"). |
| | Wenn Sie mit dem Hörempfinden in Alltagssituation nicht zufrieden sind, wenden Sie sich zur Anpassung von Vibrosonic alpha an Ihren Hörakustiker,. |
| | In dringenden Fällen darf Vibrosonic alpha von jedem HNO-Arzt entnommen werden. Legen Sie dafür Ihre Patienteninformationskarte dem Arzt vor. Suchen Sie in der Folge immer einen zertifizierten HNO-Arzt auf. |

# A1 Außerbetriebnahme und Entsorgung



Vibrosonic alpha und die enthaltene Batterie dürfen nicht im normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte diese Komponenten an den für die Entsorgung von Elektronikabfall vorgesehenen Sammelstellen entsorgen oder dem Hörakustiker zur Entsorgung übergeben. Eine fachgerechte Entsorgung schützt Umwelt und Gesundheit.

# A2 Notizen

# A3 Produktschilder

Hier bitte die Produktschilder der zugehörigen Patienten-Kits (Artikel-Nr.: FPTK001) aufkleben:

**LINKE SEITE**

**RECHTE SEITE**

Ihr HNO-Arzt:

Vibrosonic GmbH
Franz-Volhard-Straße 3
68167 Mannheim
**Germany**

CE
0483

Art.-Nr.: FGAA001
Rev. 007
09.04.2021

©2021 Vibrosonic GmbH alle Rechte vorbehalten